


筛查体内人工植入物, 仪器, 和其它金属物品。对于任何不 明详情的装置或物品,认为是磁共振不安全的(MR Unsafe)。



筛查以确保所有进入磁共振扫描室的装置或物品是条件性磁共振 兼容的(MR Conditional)或是磁共振安全的(MR Safe)。条件性磁共 振兼容装置的安全扫描条件需和磁共振仪器的扫描条件吻合。所 有的金属, 甚至非铁磁性的, 都有可能发热并造成灼伤。

请患者换掉自己的衣服, 穿上医院提供的衣服。




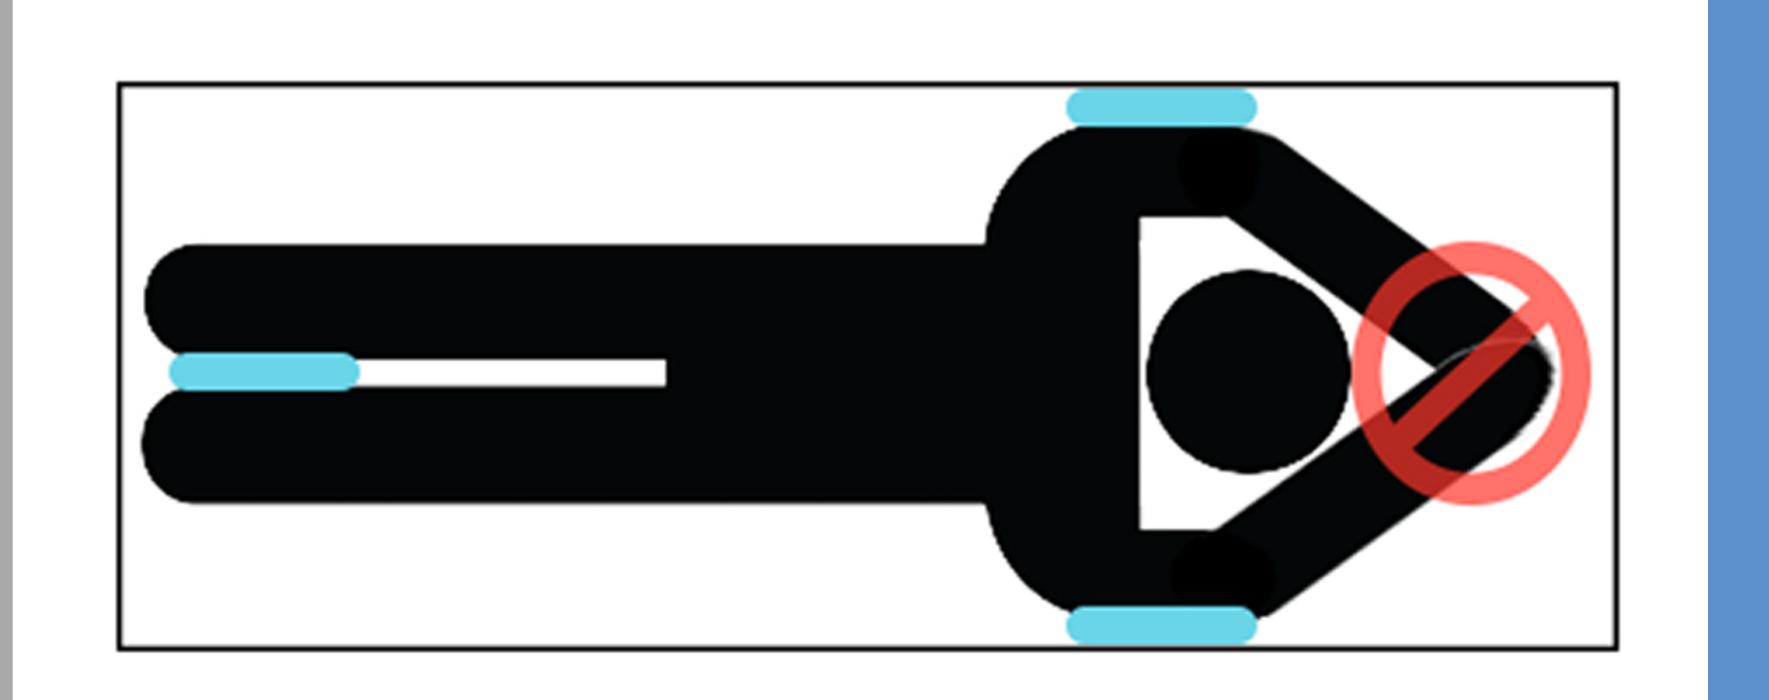

避免患者皮肤与皮肤的接触(例如,手不能接触髋部,不能 双臂交叉, 无交叉腿等)

应使用制造商提供的垫子来隔离患者的身体部位。可加入床单 和毯子来提高患者的舒适度,但都不能代替生产商提供的垫子。



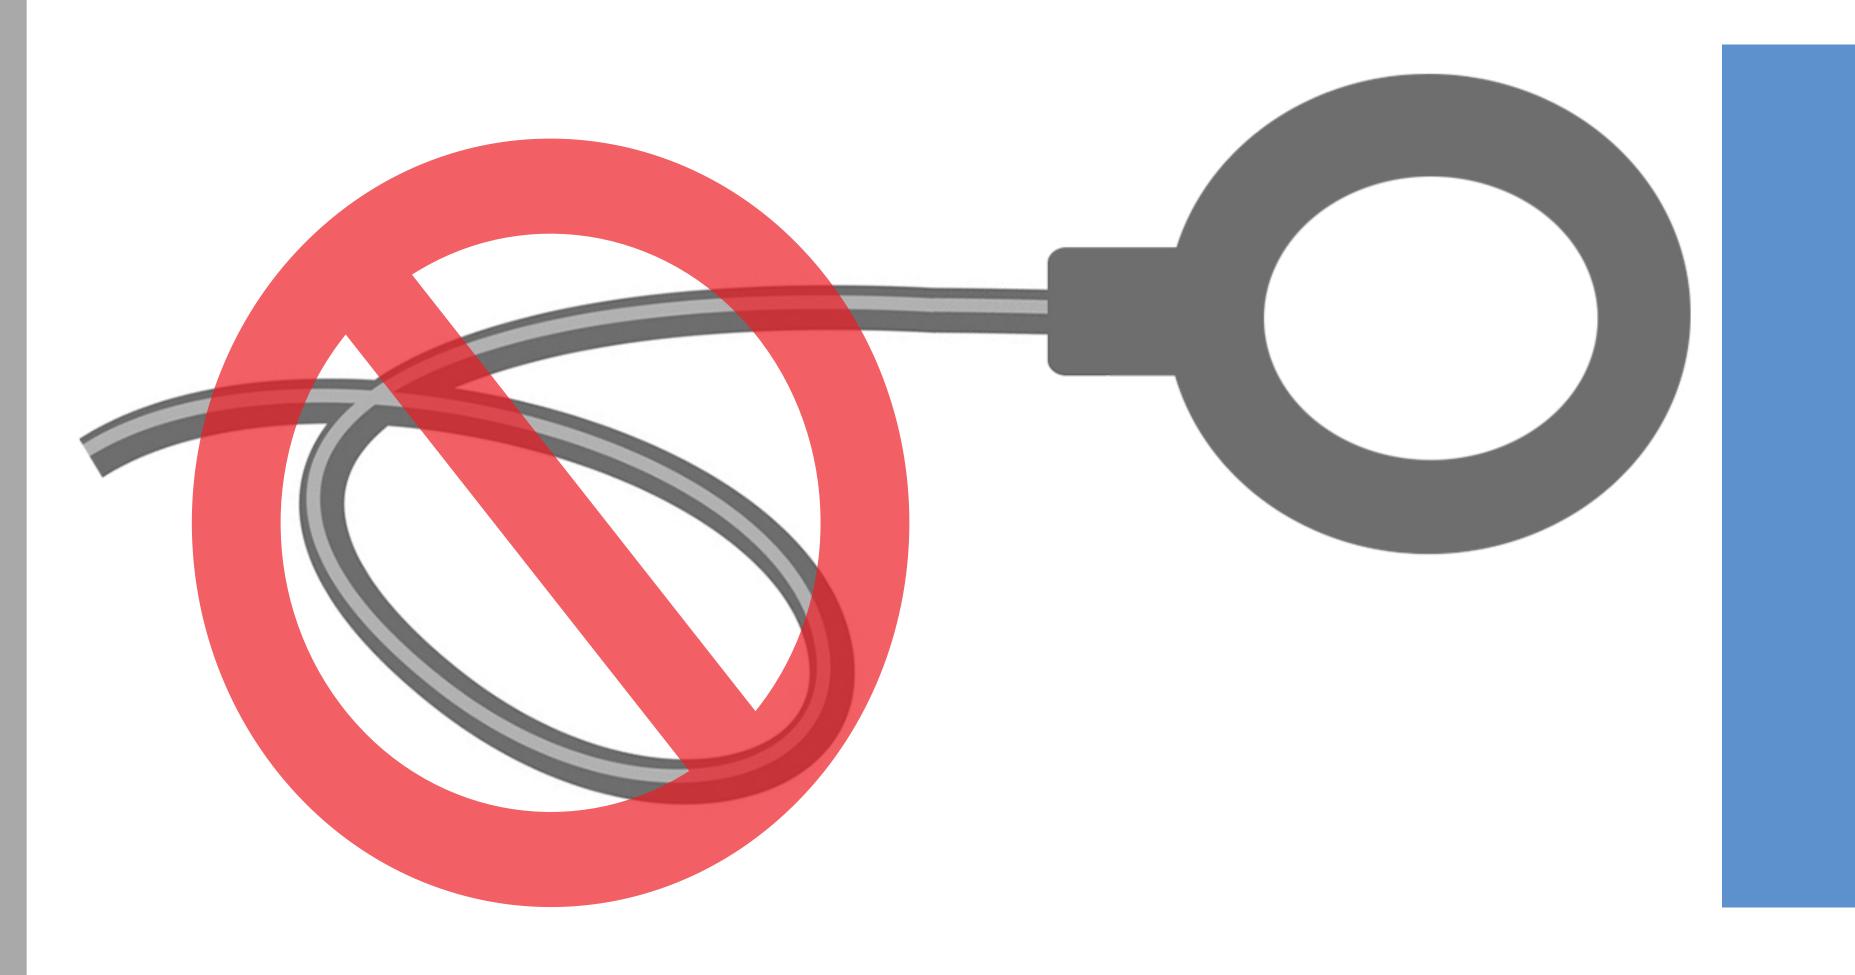

将线圈电缆顺成直线。避免电缆盘绕在一起或接触患者。

在可能的情况下,只使用正常工作模式和最低的射频能量特 定吸收率(SAR)。





保持一直观察和聆听患者。与病人沟通以发现由于扫描引起 的发热。使用条件性磁共振兼容的(MR Conditional) 显示器来 监控被镇静的患者。







免责声明: 美国食品药 品监督管理局对此翻译 不承担任何责任。